

医療機器学 第88巻 第1号掲載

「滅菌保証に関する実態調査報告書5」
記載内容の一部訂正について

平成30年2月1日発行 医療機器学 第88巻 第1号に掲載されました『滅菌保証に関する実態調査報告書5』において一部誤りがございましたので、下記の通り訂正いたします。

P-80 右段落6～7行目

誤 過酸化水素ガス低温滅菌で0%

正 過酸化水素ガス低温滅菌で24.2%

P-82 図27中の「過酸化水素ガス低温滅菌」の「すべての医材で実施」の割合

誤

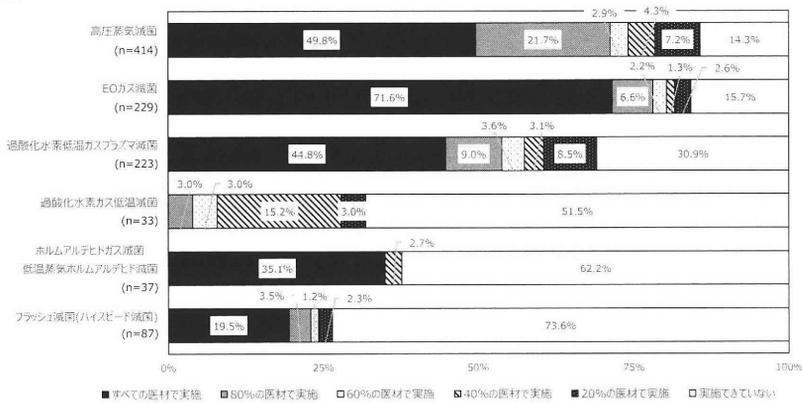


図27 インプラント器材での生物学的インジケータ判定後の払い出しの実施状況

正

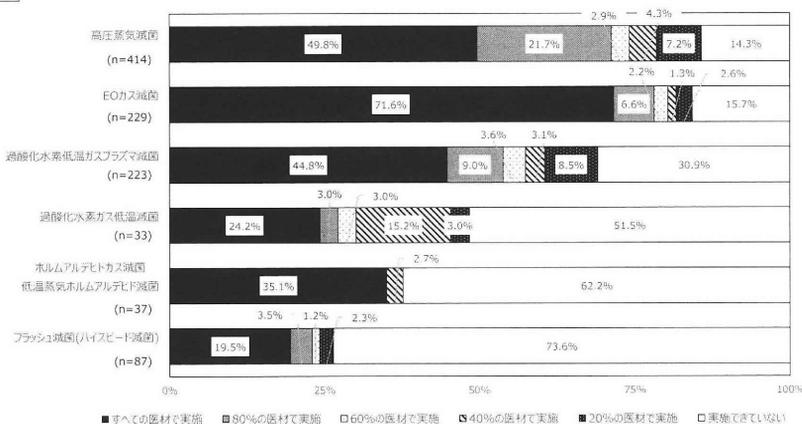


図27 インプラント器材での生物学的インジケータ判定後の払い出しの実施状況

記載内容に一部誤りがあったために会員および関係者の方々にご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。