

## お詫びと訂正

映像情報メディカル2016年12月号P31に掲載の図2に誤りがございました。ここに訂正後の図2を掲載させていただきます。このたびは、著者の先生方をはじめ、読者ならびに関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

【訂正図】映像情報メディカル2016年12月号P31図2

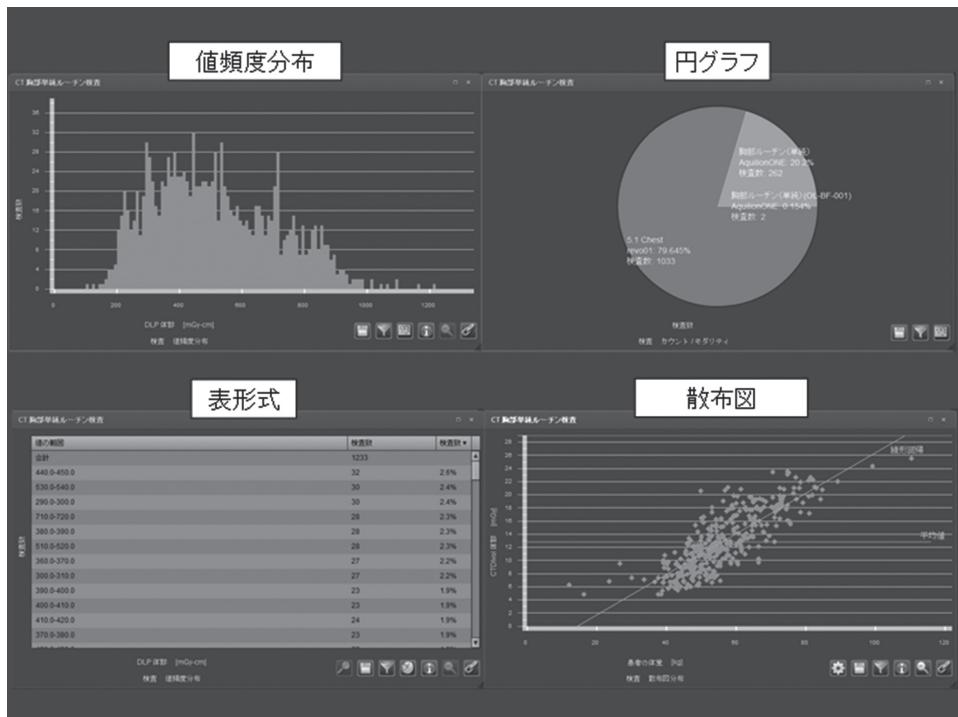


図2 インテリジェンスレポート機能(ダッシュボード機能)1例