

お詫びと訂正

映像情報メディカル2017年2月号P45に掲載の図9cに誤りがございました。ここに訂正後の図9を掲載させていただきます。このたびは、著者の先生方をはじめ、読者ならびに関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

【訂正図】映像情報メディカル2017年2月号P45図9

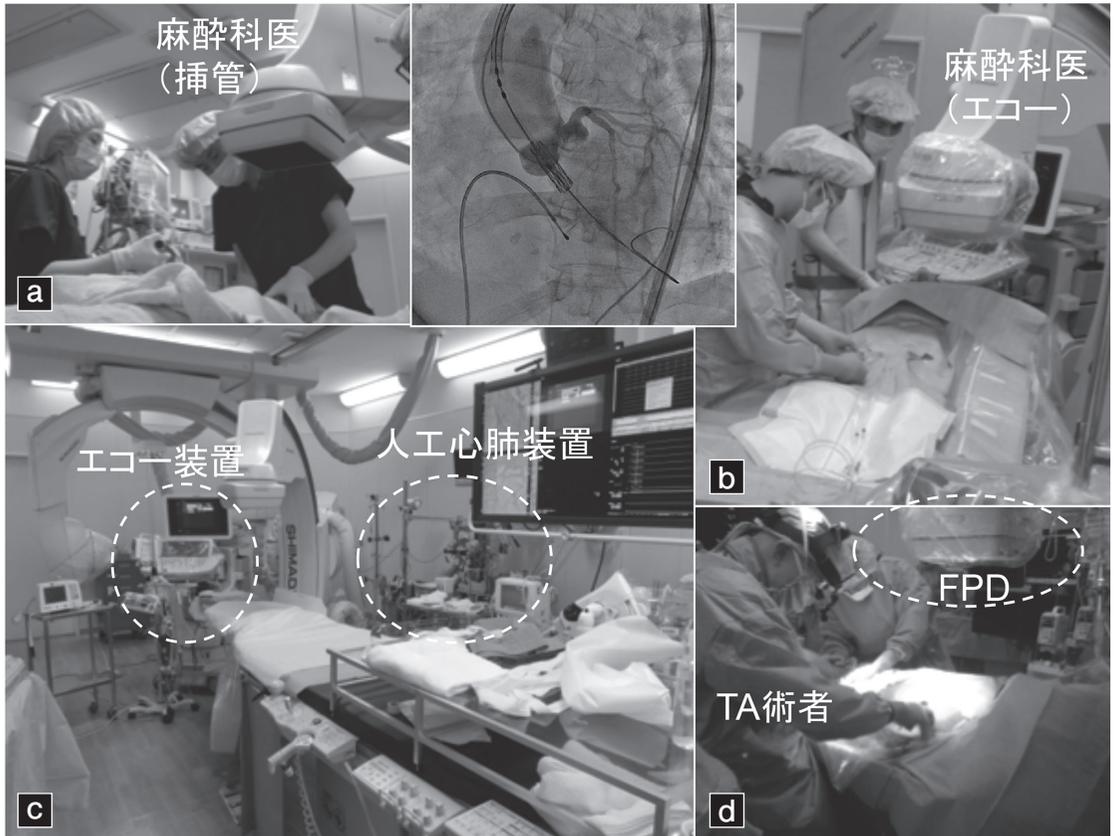


図9 TAVIの実際

- a: 挿管
- b: 手技中のエコー
- c: TAVI時のハイブリッドカテ室
- d: 経心尖アプローチ時のオペレータとFPDの位置関係