

## お詫びと訂正

映像情報メディカル2019年9月号P91に掲載の図4に誤りがございました。下記のとおり訂正させていただきますとともに、訂正後の図4を掲載いたします。このたびは、読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

【訂正箇所】映像情報メディカル2019年9月号P91 図4

■図内左から3番目のグラフ

パルス透視B社製上位機種(30×30)のフレームレート数値  
誤) 15 fps  
正) 30 fps

■図内右端のグラフ

パルス透視B社製上位機種(25×25)のフレームレート数値  
誤) 15 fps  
正) 30 fps

【訂正図】映像情報メディカル2019年9月号P91 図4

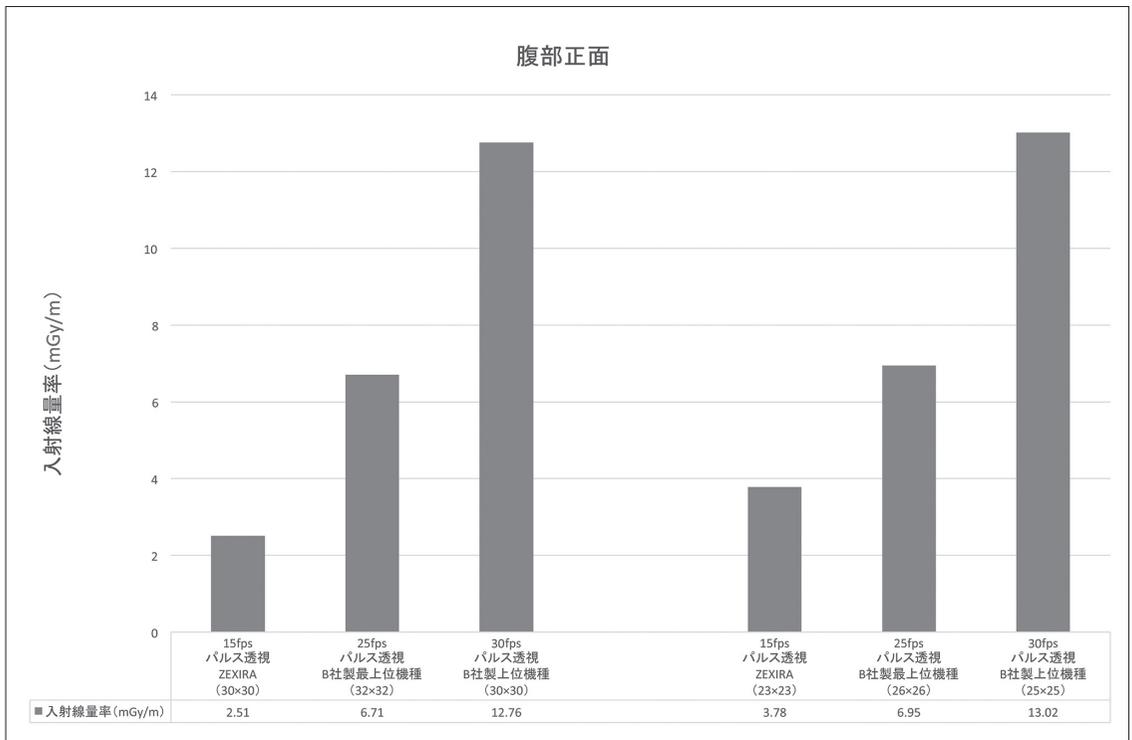


図4 実臨床の条件における各装置の透視線量実測値の比較(腹部領域)