

訂正のご案内

「CLINICAL REHABILITATION」第26巻11号(2017年10月号臨時増刊)『脳卒中リハビリテーションの最前線—実践とエビデンス』「装具治療」において、以下の箇所に誤りがございましたので、ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます。

1059 頁, 図6

(誤)



a) UD フレックス



b) オルトップ®



c) Rie Strap




d) セバ

図6 短いタイプの AFO



(正)

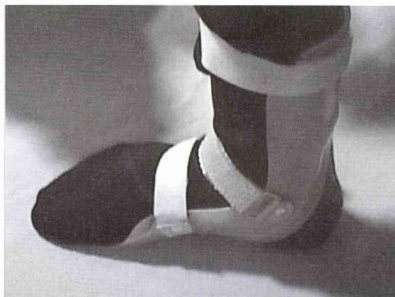


a) オルトップ®



b) UD フレックス



c) セバ

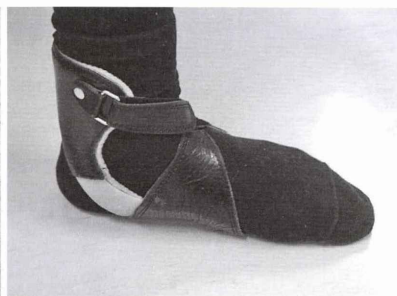

d) Rie Strap

図6 短いタイプの AFO